



Ministerio da Saúde
 Secretaria Executiva
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
 Coordenação Geral de Economia da Saúde
BPS - Banco de Preços em Saúde

Quinta-feira 19 Agosto 2021 13:44

GERAL

Usuário: Elaine Cristina Ludtk

ITENS

Código BR: 0332345

Descrição CATMAT: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A

PERÍODO


Data da Compra: 19/02/2020 à 19/08/2021

BPS

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES				
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED	MÉDIA PONDERADA
BR0332345	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA	UNIDADE	Não	10/02/2021	Pregão	18/03/2021	A	CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	MUNICIPIO DA LAPA	LAPA	PR	5000	0,1800	0,0000	N/A	0,3742
BR0332345	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA	UNIDADE	Não	24/08/2020	Pregão	01/02/2021	A	CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	NOVO HORIZONTE DO OESTE	RO	3750	0,3070	0,0000	N/A	0,3742
BR0332345	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE IV, TIPO USO:INTERNO, TIPO:MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA	UNIDADE	Não	15/12/2020	Pregão	28/01/2021	A	CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	STORE DO BRASIL EIRELI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MACEIO	AL	30000	0,3900	0,0000	N/A	0,3742

x 240 = 89,80

Fale Conosco: (61) 3315-3990 bps@saude.gov.br
 (61) 3315-3991 www.saude.gov/banco





Ministério da Saúde

Parcele em até 3x sem juros | 3% de desconto no boleto



Digite Aqui



VER CATEGORIAS

SERINGAS

MEDICAMENTOS

SCALPES

EQUIPOS

SONDAS

CATETER

APARELHOS

LIVAS

Hospitalar Distribuidora / Medicamentos / X



Xylestesin 2% Sem Vasoconstritor Com 50 Tubetes de 1,8ML (Lidocaína/Xilocaina) - Cristália

Por: **R\$ 195,30**

em até 3x de R\$ 65,10 s/ juros

ou R\$ 189,44 à vista no boleto bancário

COMPRAR

Calcular o Frete

OK

Não sei meu CEP

Descrição

A venda desse medicamento é restrita, pois nós somos distribuidores, que ao contrário de farmácias, não fazemos retenção de receitas médicas. A comercialização via CPF é permitida para profissionais que possam responder pelo uso desse medicamento, como Médicos, Médicos Veterinários, Dentistas e Biomédicos com habilitação em estética, tendo a obrigatoriedade de enviar a cópia frente e verso de suas respectivas carteiras profissionais, em um dos nossos canais de atendimento, e-mail: atendimento@hospitalardistribuidora.com.br, ou WhatsApp (18) 99764-2232. A venda para CNPJ deverá ser enviado nos mesmos canais de contato, as cópias do Alvará Sanitário, Certificado de Regularidade Técnica e o Contrato Social.

Apresentação de Xylestesin

Xylestesin 2% Sem Vasoconstritor Com 50 Tubetes de 1.8ML

Xylestesin - Informações

A Lidocaína estabiliza a membrana neuronal por inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos efetuando deste modo a ação do anestésico local.

Xylestesin - Indicações

O Xylestesin injetável é indicado para produção de anestesia local ou regional por técnicas de infiltração como a injeção percutânea; por anestesia regional intravenosa; por técnicas de bloqueio de nervo periférico como o plexo braquial e intercostal; e por técnicas neurais centrais, como os bloqueios peridural lombar e caudal.

Contraindicações de Xylestesin

A Lidocaína é contraindicada em pacientes com conhecida hipersensibilidade a anestésicos locais do tipo amida ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

Reações adversas de Xylestesin

SISTÊMICOS: As reações adversas após a administração de Lidocaína são de natureza similar àquelas observadas com outros agentes anestésicos locais do tipo amida. Estas reações adversas são, em geral, dose-relacionadas, podendo resultar de altos níveis plasmáticos, causados por dosagem excessiva, rápida absorção ou injeção intravascular acidental, podendo ainda resultar da hipersensibilidade, idiossincrasia ou da tolerância diminuída por parte do paciente. As reações adversas graves, são geralmente de natureza sistêmica. Os tipos de reações adversas mais freqüentemente relatados são os seguintes:

SISTEMA NERVOSO CENTRAL: As manifestações do SNC são excitatórias e/ou depressoras e podem ser caracterizadas por crises de ausência, nervosismo, apreensão, euforia, confusão, vertigem, sonolência, zumbido, visão nebulosa ou dupla, vômitos, sensação de calor, frio ou entorpecimento, contrações, tremores, convulsões, inconsciência, depressão e parada respiratória. As manifestações excitatórias podem ser muito breves, ou podem não ocorrer, sendo que a primeira manifestação de toxicidade poderá ser a sonolência progredindo para inconsciência e parada respiratória. A sonolência após a administração da Lidocaína é normalmente um sinal precoce de alto nível sanguíneo da droga, podendo ocorrer como consequência de sua rápida absorção.

SISTEMA CARDIOVASCULAR: Manifestações cardiovasculares são normalmente depressivas, caracterizadas por bradicardia, hipotensão e colapso cardiovascular, podendo resultar em parada cardíaca.

ALÉRGICAS: As reações alérgicas são caracterizadas por lesões cutâneas, urticária, edema ou reações anafilatóides. As reações alérgicas podem ser resultantes da sensibilidade ao agente anestésico local, aos bisulfitos ou ao metilparabeno usado como conservante em frascos de múltiplas doses. As reações alérgicas resultantes da sensibilidade à lidocaína são extremamente raras e quando ocorrem devem ser monitoradas por meios convencionais. A detecção da sensibilidade por testes na pele é de valor duvidoso.

NEUROLÓGICAS: As incidências de reações adversas associadas ao uso de anestésicos locais podem estar relacionadas à dose total administrada e dependem também da particularidade da droga usada, a via de administração e o estado físico do paciente. Em estudo realizado com 10.440 pacientes que receberam lidocaína para anestesia espinal, a incidência de reações adversas relatadas foram de cerca de 3% para dor de cabeça postural, hipotensão e dor nas costas; 2% para calafrios e menos que 1% para sintomas nervosos periféricos, náusea, respiração inadequada e visão dupla. Muitas dessas observações podem estar relacionadas com a técnica anestésica usada, com ou sem a contribuição do anestésico local. Na prática do bloqueio peridural caudal ou lombar pode ocorrer introdução não intencional no espaço subaracnóideo pelo cateter. Subseqüentes reações adversas podem depender particularmente da quantidade de droga administrada no espaço subaracnóideo. Isto pode incluir bloqueio espinal de grandeza variada (incluindo bloqueio espinal total), hipotensão secundária ao bloqueio espinal, perda do controle da bexiga e intestino, e perda da sensação perineal e função sexual. A persistente deficiência motora, sensorial e/ou autonômica (controle do esfíncter) de alguns segmentos espinais inferiores, com lenta recuperação (vários meses) ou incompleta recuperação, têm sido relatado raramente, quando da realização de bloqueio peridural caudal ou lombar. Dores nas costas e cefaléia têm sido observadas na utilização destes procedimentos anestésicos.

Xylestesin - Posologia

A Tabela de Dosagens Recomendadas resume os volumes e concentrações de Cloridrato de Lidocaína para os vários tipos de procedimentos anestésicos. As dosagens sugeridas nesta tabela são para adultos normais saudáveis e refere-se ao uso de solução sem vasoconstritor. Quando grandes volumes são necessários, somente soluções com vasoconstritor devem ser usadas, exceto naqueles casos em que as drogas vasopressoras são contra-indicadas. Estas doses recomendadas servem somente como guia para a quantidade de anestésico necessária na maioria dos procedimentos de rotina. Os volumes e concentrações reais a serem usadas, depende de fatores tais como, o tipo e extensão do procedimento cirúrgico, intensidade da anestesia e extensão do relaxamento muscular necessário, duração necessária da anestesia e da condição física do paciente. Em todos os casos devem ser adotadas a mais baixa concentração e a menor dose que produzam os resultados desejáveis. As dosagens devem ser reduzidas para crianças, para pacientes idosos e debilitados e para pacientes com doenças cardíacas e/ou hepáticas. O início da anestesia, a duração da anestesia e a extensão do relaxamento muscular são proporcionais ao volume e concentração (dose total) do anestésico local usado. Portanto, o aumento de concentração e volume do injetável de Cloridrato de Lidocaína, diminui o tempo de início da anestesia, prolonga a duração da anestesia, promove uma grande extensão do relaxamento muscular e aumenta a expansão segmentar da anestesia. Entretanto, aumentando o volume e concentração do Cloridrato de Lidocaína, pode resultar numa profunda queda de pressão sanguínea quando usado em anestesia peridural. Embora a incidência de outros efeitos com Lidocaína seja muito baixa, deve ser executado com cautela o emprego de grandes volumes e concentrações, visto que a incidência de outros efeitos é diretamente proporcional à dose total do agente anestésico local injetado. Dosagens Recomendadas de Injetável de Cloridrato de Lidocaína (Sem Epinefrina) PROCEDIMENTO CONCENTRAÇÃO VOLUME DOSE

Whois

www.hospitalardistribuidora.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-18 16:11:53 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: hospitalardistribuidora.com.br
 titular: HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 documento: 03.375.328/0001-88
 responsável: Wilson José Pinto da Silva
 país: BR
 c-titular: HODIS2
 c-técnico: LPSFM
 servidor DNS: dale.ns.cloudflare.com
 status DNS: 17/08/2021 AA
 último AA: 17/08/2021
 servidor DNS: lara.ns.cloudflare.com
 status DNS: 17/08/2021 AA
 último AA: 17/08/2021
 criado: 18/04/2008 #4402212
 alterado: 07/10/2020
 expiração: 18/04/2022
 status: Publicado
 contato (ID): HODIS2
 nome: Hospitalar Distribuidora
 e-mail: vendas@hospitalardistribuidora.com.br
 país: BR
 criado: 04/08/2009
 alterado: 06/06/2018
 contato (ID): LPSFM
 nome: Luz Própria Soluções Fotográficas e Web
 e-mail: hospedagem@luzpropria.com
 país: BR
 criado: 23/10/2008
 alterado: 22/03/2021

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Tapete (moveis-e-decoracoes/decoracao/tapetes/)
Espelho (moveis-e-decoracoes/decoracao/espelhos-decorativos/)
Adepsivo de parede (moveis-e-decoracoes/decoracao/adesivos-de-parede/)

Roupas e Acessórios (moda/)

Roupas Femininas (moda/moda-feminina/)

Camisas Femininas (moda/moda-feminina/camisas/)

Buzas Femininas (moda/moda-feminina/buzas/)

Molotom Feminino (moda/moda-feminina/molotom/)

Casaco Feminino (moda/moda-feminina/casacos-e-jaquetas/)

Vestido (moda/moda-feminina/vestidos/)

Body (moda/moda-feminina/body/)

Saiia (moda/moda-feminina/saias/)

Plus Size Feminino (moda/moda-plus-size-feminino/)

Roupas Masculinas (moda/moda-masculina/)

Camisetas Masculinas (moda/moda-masculina/camisetas/)

Camisas Masculinas (moda/moda-masculina/camisas/)

Blazer Masculino (moda/moda-masculina/blazers/)

Molotom Masculino (moda/moda-masculina/molotom/)

Casaco Masculino (moda/moda-masculina/casacos-e-jaquetas/)

Bermuda Masculina (moda/moda-masculina/bermundas/)

Vestido Infantil (moda/moda-infantil/)

Roupas de Bebê (moda/moda-bebe/)

Acessórios (moda/acessorios-de-moda/)

Calçados (moda/calçados/)

Calçados Femininos (moda/calçados-femininos/)

Sapatilha (moda/calçados-femininos/sapatilha/)

Calçados Femininos (moda/calçados-femininos/)

Botas Femininas (moda/calçados-femininos/botas/)

Tênis Feminino (moda/calçados-femininos/tenis/)

Calçados Masculinos (moda/calçados-masculinos/)

Botas Masculinas (moda/calçados-masculinos/botas/)

Calçados Masculinos (moda/calçados-masculinos/)

Sapatão Masculino (moda/calçados-masculinos/sapatão/)

Calçados Masculinos (moda/calçados-masculinos/)

Sapatênis Masculino (moda/calçados-masculinos/sapatênis/)

Tênis Masculino (moda/calçados-masculinos/tenis/)

Lazer & Cultura (lazer/)

CD (cds-dvds-e-blu-rays/cds/)

DVD (cds-dvds-e-blu-rays/dvds/)

Blu-Ray (cds-dvds-e-blu-rays/blu-ray/)

Jogo de Mesa (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)

Esporte e Lazer (lazer/)



Antisséptico
Bucal Listerine
Sem Alcool Cool
Mint - 1,5L

R\$ 56,91

ou 3x de R\$ 18,97

(https://shopfacil.vteximg.com.br/arquivos/ids/76905296/7063195_1.jpg)

Parcelamento

Magazine Luiza (selite-infos)

seletri=00443713)

Variação

Im Alcool

sterine

COMPRAR

Compre Segura

Para nos adaptarmos a seus gostos e preferências e melhorar nossos serviços, analisamos seus hábitos de navegação neste site por meio de cookies, conforme nossa Política de Privacidade (/institucional/politica-de-privacidade)

FECHAR

Valor e prazo de Entrega

Digite um CEP

OK

Não sei meu CEP

(https://www.buscacero.com.br/sitemas/buscacero/)

O prazo de entrega passa a contar após o status de pagamento aprovado

Melhor opção de preço

(*) Ver Avaliações

Home (https://www.shopfacil.com.br/beleza) Corpo e Banho (https://www.shopfacil.com.br/beleza/corpo-e-banho)

Higiene Bucal (https://www.shopfacil.com.br/beleza/corpo-e-banho/higiene-bucal)

Whois

www.shopfacil.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2021-08-18 15:59:01 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: shopfacil.com.br
titular: Scopus Solucoes em TI LTDA
documento: 14.380.750/0001-40
responsável: Wagner Fonseca
país: BR
c-titular: WAOFO
c-técnico: RFDSA266
servidor DNS: ns1.scopus.com.br
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
servidor DNS: ns2.scopus.com.br
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
servidor DNS: ns3.scopus.com.br
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
servidor DNS: ns4.scopus.com.br
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
criado: 02/08/1999 #183846
alterado: 10/08/2021
expiração: 02/08/2022
status: Publicado

Contato (ID): WAOFO
nome: Wagner Oliveira da Fonseca
e-mail: wolfonseca@scopus.com.br
país: BR
criado: 03/04/2009
alterado: 08/06/2018

Contato (ID): RFDSA266
nome: Roseane Freire dos Santos
e-mail: rfreire@scopus.com.br
país: BR
criado: 11/06/2012
alterado: 16/07/2020

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)





Minha Cesta

Todas as Categorias

Ofertas

Teleconsulta

Dermocosméticos

Higiene e beleza

Mamães e bebês

Medicamentos especiais

Manipulação

[Home](#) > [Cuidados Pessoais e Beleza](#) > [Higiene bucal](#) > [Antisséptico Bucal Listerine Zero 1,5l](#)


Referência: 53813

★★★★★

Listerine

★★★★★

Antisséptico Bucal Listerine Zero 1,5l

R\$ 47,24

R\$ 44,99

Economize R\$ 2,25

COMPRAR

- 1 +

Informações de entrega

Calcular frete

Calcular

Não sei meu CEP [?](#)
 Retire grátis na loja - Em 1 hora.

 Frete grátis - Em compras acima de R\$ 150.

Vendido e entregue por Farmácias Pague Menos

Quem viu este produto, viu também



Dorflex Com 50 Comprimidos

R\$ 21,45

22% OFF

ADICIONAR



Desodorante Antitranspirante Aerosol NIVEA Dermo Clareado...

R\$ 13,99

ADICIONAR



Desodorante Antitranspirante Aerosol NIVEA Invisible for Black...

R\$ 13,99

ADICIONAR



Kit Balance Kids Sabonete Líquido Com 2 Unidades De 200ml

R\$ 18,99

ADICIONAR

Descrição do Produto

O Listerine Zero é um antisséptico bucal que remove até 99% dos germes que causam placa, gengivite e mau hálito. Sua fórmula suave e zero álcool oferece até 12 horas de proteção para que seu sorriso fique bonito e saudável, alcançando onde o fio e a escova não chegam. Nenhum outro antisséptico bucal sem álcool é mais efetivo em remover os germes do que Listerine Zero. Sabor suave e zero álcool, com fórmula exclusiva efetiva em matar os germes que causam a placa, gengivite e o mau hálito.

[Ver bula](#)

Avaliações

5 estrelas	17
4 estrelas	1
3 estrelas	0
2 estrelas	0
1 estrela	0



18 avaliações



100% Recomendam este produto

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-18 16:05:46 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: paguemenos.com.br
titular: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA
documento: 06.626.253/0001-51
responsável: DEUSMAR QUEIROS
país: BR
c-titular: AJV9
c-técnico: AJV9
servidor DNS: ns.paguemenos.com.br 187.32.141.157
status DNS: 14/08/2021 AA
último AA: 14/08/2021
servidor DNS: ns2.paguemenos.com.br 189.84.116.173
status DNS: 14/08/2021 AA
último AA: 14/08/2021
criado: 11/07/1996 #11507
alterado: 29/04/2021
expiração: 11/07/2023
status: Publicado
```

```
Contato (ID): AJV9
nome: Afro Jose Campos de Vasconcelos
e-mail: afro@pmenos.com.br
país: BR
criado: 30/04/1999
alterado: 25/08/2016
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)


FRETE GRÁTIS a partir de R\$99 para SÃO PAULO e a partir de R\$199 para TODO BRASIL (Exceto toxinas).

Precisa de ajuda?

Home (https://www.dentalgutierre.com.br) Estética E Dentística (https://www.dentalgutierre.com.br/estetica-e-dentistica) Cariostático (https://www.dentalgutierre.com.br/estetica-e-dentistica/cariostatico)

Cariestop 12% 10mL Biodinamica código: 011473

AVALIE

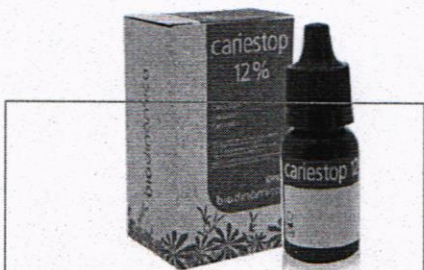

R\$ 46,28

QUANTIDADE

1

Adicionar ao Carrinho

Comprar

► CONSULTE SEU FRETE

Indicações	Características e benefícios	Apresentação
Destinado para prevenir o surgimento de cáries.		

PRODUTOS RELACIONADOS

 <p>(/produto/selante-bioforty-foto-5ml-biodinamica-102678)</p> <p>Selante Bioforty Foto 5mL Biodinamica</p> <p>(/produto/selante-bioforty-foto-5ml-biodinamica-102678)</p> <p>R\$ 80,70</p> <p>(/produto/selante-bioforty-foto-5ml-biodinamica-102678)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	 <p>SEM FOTO</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-oa3-biodinamica-114232)</p> <p>Resina Master Fill 4grs OA3 Biodinamica</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-oa3-biodinamica-114232)</p> <p>R\$ 7,60</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-oa3-biodinamica-114232)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	 <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b3-biodinamica-114230)</p> <p>Resina Master Fill 4grs B3 Biodinamica</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b3-biodinamica-114230)</p> <p>R\$ 18,99</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b3-biodinamica-114230)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	 <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b2-biodinamica-114229)</p> <p>Resina Master Fill 4grs B2 Biodinamica</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b2-biodinamica-114229)</p> <p>R\$ 18,99</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b2-biodinamica-114229)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	 <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b1-biodinamica-114228)</p> <p>Resina Master Fill 4grs B1 Biodinamica</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b1-biodinamica-114228)</p> <p>R\$ 18,99</p> <p>(/produto/resina-master-fill-4grs-b1-biodinamica-114228)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>
---	--	---	--	---

AVALIAR O PRODUTO

Preencha seus dados, avalie e clique no botão Avaliar Produto.

Nome

E-mail

Comentário

INDIQUE A UM AMIGO

Preencha os campos abaixo e clique em Indicar Produto. A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.

Nome de um amigo

E-mail de um amigo

Meu Nome

Meu E-mail

Comentário

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.

Entendi

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2021-08-18 16:31:33 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          dentalgutierre.com.br
titular:          Gutierre Central de Compras Odont SA
documento:        07.404.801/0001-61
responsável:     Fabio Augusto Scalli
país:             BR
c-titular:        CAG662
c-técnico:        FDSSA11
servidor DNS:    ns1.softlayer.com
status DNS:      16/08/2021 AA
último AA:       16/08/2021
servidor DNS:    ns2.softlayer.com
status DNS:      16/08/2021 AA
último AA:       16/08/2021
criado:          19/01/2010 #6455719
alterado:        30/09/2019
expiração:       19/01/2022
status:          Publicado


Contato (ID):    CAG662
nome:           Célia A. U. Gutierre
e-mail:         atendimento.ti@dentalgutierre.com.br
país:           BR
criado:         01/03/2006
alterado:       10/07/2021

Contato (ID):    FDSSA11
nome:           FBITS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A..
e-mail:         infra@traycorp.com.br
país:           BR
criado:         20/02/2013
alterado:       03/11/2020
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)




Digite o que você procura...

Produto Indicação Características

Cariostático Cariestop 12% - Biodinâmica

Cod. de Referência: 214567

☆☆☆☆☆ (0) Avalie este produto



Frasco com 10ml.

Frete Grátis! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00*

R\$48,59

Condições de Pagamento [+]

QUANTIDADE: 1

Comprar

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a confirmação de pagamento.

Calcular Frete

Indicação

A solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéticos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação anti-microbiana se dá principalmente por sua ação sobre S. mutans. Estudos relataram uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos.

Características

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

ESCREVER AVALIAÇÃO...

Este site utiliza cookies. Para saber mais clique aqui.

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

Faça sua sugestão

Visite nosso Blog

Institucional

Ajuda

Assistente Virtual

Acompanhe seu Pedido

Dental Cremer Lovers

Atualizar Boleto

Catálogos de Marcas

Política Comercial

IDoc

Política de Privacidade

Nosso App

Sobre a Dental Cremer

Atendimento

0800 727 7565

Seg. a Sex. das 8h às 20h
Sáb. das 9h às 13h

Baixe nosso App



Cartão de Crédito
Parcela em até 12x sem juros

Boleto a prazo
Parcela em até 6x sem juros

Boleto à vista
Ganhe 3% de desconto

Whois

www.dentalcremer.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2021-08-18 16:29:53 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          dentalcremer.com.br
titular:         DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
documento:      14.190.675/0001-55
responsável:    Paulo Batista
país:           BR
c-titular:      DECRE13
c-técnico:      DECRE13
servidor DNS:   ns-1643.awsdns-13.co.uk
status DNS:    18/08/2021 AA
último AA:     18/08/2021
servidor DNS:   ns-369.awsdns-46.com
status DNS:    18/08/2021 AA
último AA:     18/08/2021
servidor DNS:   ns-1015.awsdns-62.net
status DNS:    18/08/2021 AA
último AA:     18/08/2021
servidor DNS:   ns-1354.awsdns-41.org
status DNS:    18/08/2021 AA
último AA:     18/08/2021
criado:         28/03/2003 #1158372
alterado:      09/08/2016
expiração:     28/03/2025
status:        Publicado

Contato (ID):   DECRE13
nome:          Dental Cremer
e-mail:        dominios@dentalcremer.com.br
país:          BR
criado:        22/11/2013
alterado:      07/01/2016
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

FRETE GRÁTIS PARA SUL E SUDESTE (Ver Regras)

EMAIL: atendimento@azefix.com.br | SAC | Nossa Empresa


[Meus Pedidos](#) [Meus Favoritos](#) [Meu Carrinho](#) [Finalizar](#) [Entrar](#)
[Cliente Mercado Livre - Atualize seu Cadastro clicando aqui!](#)

Início / Touca Descartável TNT Tipo Gorro de Amarrar Branca 100 und.

Categorias

[Saldão / Outlet](#)[Calçados de Proteção](#)[Luvas](#)[Descartáveis](#)[Linha Frigorífica](#)[Facas, Chaias e Utensílios](#)[Aventais / Capas / Vestimentas](#)[Proteção Térmica](#)[Proteção Respiratória](#)[Proteção Auditiva](#)[Proteção a Altura](#)[Proteção Visual e Facial](#)[Cremes e Higiênização](#)[Capacetes de Segurança](#)[Ergonomia](#)[Sinalização](#)[Embalagens e Papelaria](#)

Clique na imagem acima para ampli-la.

MAIS IMAGENS



Touca Descartável TNT Tipo Gorro de Amarrar Branca 100 und. (Ref. AZ0567)

Dê Sua Opinião Sobre o Produto

Touca Descartável TNT Tipo Gorro c/ Tiras Laço de Amarrar Branca 100 und.

Disponível: Em estoque

De: ~~R\$60,00~~Por: **R\$53,90**Qtde: [Comprar](#)[Adicionar aos Favoritos](#)
[Descrição](#) [Informação Adicional](#) [Tags](#)

Touca Descartável TNT Tipo Gorro c/ Tiras Laço de Amarrar Branca 100 und.

UTILIZADO

Hospitais, clínicas, estética, indústria alimentícia, cozinha industrial, etc.

ESPECIFICAÇÕES

Confeccionado em TNT - Tecido Não Tecido

100% polipropileno.

Material Descartável.

Atóxico.

Cor: Branco.

Gramatura: 20gr.

Embalagem: 100 und.

Tamanho: Único.

DICAS



Conservar em local arejado em temperatura ambiente.

NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE.

DISPONIBILIDADE

Imediata.

Produto com Registro ANVISA.

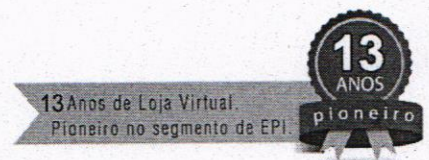

Institucional

[Quem Somos](#)[Como Comprar](#)[Contato](#)

Serviços

[Segurança](#)[Troca e Devoluções](#)[Formas de Entrega](#)[Formas de Pagamento](#)

Redes Sociais



Fale Conosco

atendimento@azefix.com.br

Whois

www.azefix.com.br

🔍

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-18 16:36:31 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:	azefix.com.br
titular:	AZEFIX EPI DE A A Z COM DE EQUIP LTDA - ME
documento:	09.462.834/0001-72
responsável:	Ronaldo Cobre
país:	BR
c-titular:	RTCI1
c-técnico:	ONNET2
servidor DNS:	b111.ns.cloudflare.com
status DNS:	18/08/2021 AA
último AA:	18/08/2021
servidor DNS:	bonnie.ns.cloudflare.com
status DNS:	18/08/2021 AA
último AA:	18/08/2021
criado:	15/05/2008 #4477293
alterado:	15/04/2021
expiração:	15/05/2024
status:	Publicado
Contato (ID):	RTCI1
nome:	Ronaldo Tomlrvtll Cobre
e-mail:	ronaldocobre@gmail.com
país:	BR
criado:	10/12/1999
alterado:	06/11/2015
Contato (ID):	ONNET2
nome:	Ondc Networks
e-mail:	hostmaster@corp.sanInternet.com
país:	BR
criado:	08/05/2013
alterado:	19/11/2019

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. Whois Registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

🔍 PESQUISAR NOVAMENTE

NIC BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
 CNPJ: 05.506.560/0001-96

Bem-vindo a nossa loja! (/gorro-branco-20gr-com-tiras-de-amarrar-c-100-medgauze-p3166/p)

WhatsApp (https://api.whatsapp.com/send?i=pt_br&phone=5516993714588)

Telefones: (16) 3236-4598

O que você procura?



Faça login (/gorro-branco-20gr-com-tiras-de-amarrar-c-100-medgauze-p3166/p)

Carrinho 0

Todos Produtos
 Harmonização
 Balanças
 Descartáveis
 Diabetes
 Esterilização
 Laboratório
 Luvas
 Material Médico
 Medicamentos
 Saneantes

[INÍCIO \(/\)](#) >
 [MATERIAL MÉDICO \(/MATERIAL-MEDICO-5466/\)](#) >
 [TOUCAS / GORROS \(/MATERIAL-MEDICO-5466/TOUCAS-GORROS-5780/\)](#)

GORRO BRANCO 20GR COM TIRAS DE AMARRAR C/100 MEDGAUZE

Cód: 3263

(0 avaliações)

O Gorro descartável Clean (Med Gauze), são projetados e fabricados para a proteção de profissionais da área da saúde e outras áreas durante a realização de procedimentos em geral.

MARCA: MEDGAUZE (/MEDGAUZE/)

Disponibilidade: Postagem em até 5 dias úteis após a confirmação de pagamento.

R\$ 36,11 à vista

R\$ 37,23

1x de R\$ 37,23 s/ juros

- 1 +

COMPRAR

Calcule a entrega

Calcular



GORRO BRANCO 20GR COM TIRAS DE AMARRAR C/100 MEDGAUZE

O Gorro descartável Clean (Med Gauze), são projetados e fabricados para a proteção de profissionais da área da saúde e outras áreas durante a realização de procedimentos em geral.

O Gorro de serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado. No caso de proteção do produto, o gorro descartável evita que cabelos caiam no produto manuseado correndo o risco de contaminação.

O Gorro descartável clean é confeccionada em não-tecido (TNT) em 100% polipropileno, matéria prima mais avançada disponível atualmente no mercado, com qualidade, padronização, uniformidade e higiene que atendam as normas e exigências da ANVISA.

ESPECIFICAÇÕES:

- Gramadura: 20.
- Composição: 100% Polipropileno (TNT).
- Cor: Branco.
- Embalagem com 100 (cem) unidades.

ATENÇÃO:

- Descartar após o uso.
- Atóxico e NÃO ESTÉRIL.
- Evitar calor excessivo e umidade.
- Manter em local seco e arejado.
- Temperatura de fusão = 165°C

Atendimento WhatsApp

Whois

www.primetricuriga.com.br

q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-18 16:35:23 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:	primetricuriga.com.br
título:	CIRURGICA ESTILO LTDA
documento:	09.592.986/0001-00
responsável:	THIAGO DA SILVA CAVALLINI
país:	BR
c-título:	THCAV2
c-técnico:	POINT3
servidor DNS:	ns632.hostgator.com.br
status DNS:	15/08/2021 AA
último AA:	15/08/2021
servidor DNS:	ns633.hostgator.com.br
status DNS:	15/08/2021 AA
último AA:	15/08/2021
sacl:	yes
criado:	02/01/2015 #13690987
alterado:	13/08/2021
expirado:	02/01/2028
status:	Publicado
Contato (ID):	THCAV2
nome:	Thiago Cavallini
e-mail:	thiago.cavallini@cloud.com
país:	BR
criado:	04/07/2008
alterado:	12/08/2021
Contato (ID):	POINT3
nome:	Pote Interativo
e-mail:	gabriel@conver.tize.com.br
país:	BR
criado:	23/02/2010
alterado:	07/06/2019

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e abuse@cert.br.
 whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

q PESQUISAR NOVAMENTE

FRETE GRÁTIS a partir de R\$99 para SÃO PAULO e a partir de R\$199 para TODO BRASIL (Exceto toxinas).

Precisa de ajuda?

Home (<https://www.dentalgutierre.com.br/>) Estética E Dentística (<https://www.dentalgutierre.com.br/estetica-e-dentistica>)
 Iônimo (<https://www.dentalgutierre.com.br/estetica-e-dentistica/ionomero>)
 Iônimo Para Restauração (<https://www.dentalgutierre.com.br/estetica-e-dentistica/ionomero/ionomero-para-restauracao>)

0% OFF




Vitro Fil LC Kit Restaurador Fotopolimerizável - Nova DFL

Código: 005041

AVALIE

Selecione a cor:

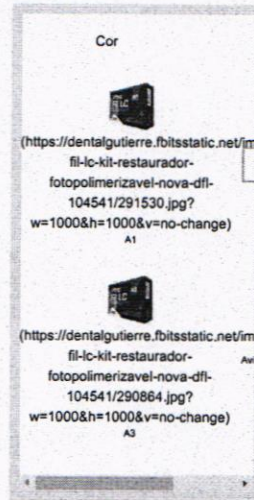

R\$ 189,90

R\$ 189,90

Adicionar ao Carrinho

Comprar

► CONSULTE SEU FRETE

Indicações	Características e benefícios	Apresentação
<ul style="list-style-type: none"> - Indicado para restaurações classes III e V e em classes I e II quando não houver ponto de contato; - Forramento de cavidades; - Reconstrução de núcleos; - Restauração de erosões cervicais e de caries de superfícies radiculares. 		

PRODUTOS RELACIONADOS

 <p>(/produto/vitro-fil-a3-restaurador-autopolimerizavel-po-liq-nova-dfl-103966)</p> <p>Vitro Fil A3 Restaurador Autopolimerizavel Po+Liq Nova Dfl</p> <p>(/produto/vitro-fil-a3-restaurador-autopolimerizavel-po-liq-nova-dfl-103966)</p> <p>R\$ 59,90</p> <p>(/produto/vitro-fil-a3-restaurador-autopolimerizavel-po-liq-nova-dfl-103966)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	<p>-40%</p>  <p>(/produto/vitro-fil-lc-a3-kit-114884)</p> <p>PROMOÇÃO</p> <p>VITRO FIL LC A3 KIT RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL NOVA DFL OUT/2021</p> <p>(/produto/vitro-fil-lc-a3-kit-restaurador-fotopolimerizavel-nova-dfl-out-2021-114884)</p> <p>R\$ 126,09</p> <p>R\$ 76,16</p> <p>(/produto/vitro-fil-lc-a3-kit-restaurador-fotopolimerizavel-nova-dfl-out-2021-114884)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	 <p>SEM FOTO</p> <p>(/produto/vitro-molar-a3-restaurador-odontopediatria-art-po-liq-nova-dfl-103968)</p> <p>Vitro Molar A3 Restaurador Odontopediatria Art Po+Liq Nova Dfl</p> <p>(/produto/vitro-molar-a3-restaurador-odontopediatria-art-po-liq-nova-dfl-103968)</p> <p>R\$ 112,90</p> <p>(/produto/vitro-molar-a3-restaurador-odontopediatria-art-po-liq-nova-dfl-103968)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	 <p>(/produto/vitro-molar-a3-restaurador-odontopediatria-art-po-liq-nova-dfl-112899)</p> <p>Vitro Molar A3 Restaurador Odontopediatria Art Po+Liq Nova Dfl</p> <p>(/produto/vitro-molar-a3-restaurador-odontopediatria-art-po-liq-nova-dfl-112899)</p> <p>R\$ 51,54</p> <p>(/produto/vitro-molar-a3-restaurador-odontopediatria-art-po-liq-nova-dfl-112899)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>	 <p>(/produto/vitro-cem-a3-ionomero-cimentacao-po-liq-nova-dfl-103965)</p> <p>Vitro Cem A3 Ionometro Cimentacao Po+Liq Nova Dfl</p> <p>(/produto/vitro-cem-a3-ionomero-cimentacao-po-liq-nova-dfl-103965)</p> <p>R\$ 70,25</p> <p>(/produto/vitro-cem-a3-ionomero-cimentacao-po-liq-nova-dfl-103965)</p> <p>1</p> <p>Comprar</p>
---	--	--	--	--

Whois

www.dentalgutierre.com.br

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2021-08-19 14:23:22 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          dentalgutierre.com.br
titular:          Gutierre Central de Compras Odont SA
documento:        07.404.801/0001-61
responsável:      Fabio Augusto Scalll
país:             BR
c-titular:        CAG662
c-técnico:        FDSSA11
servidor DNS:     ns1.softlayer.com
status DNS:       16/08/2021 AA
último AA:        16/08/2021
servidor DNS:     ns2.softlayer.com
status DNS:       16/08/2021 AA
último AA:        16/08/2021
criado:           19/01/2010 #6455719
alterado:         30/09/2019
expiração:        19/01/2022
status:           Publicado

Contato (ID):     CAG662
nome:             Célia A. U. Gutierre
e-mail:           atendimento.ti@dentalgutierre.com.br
país:             BR
criado:           01/03/2006
alterado:         10/07/2021


Contato (ID):     FDSSA11
nome:             FBITS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A..
e-mail:           infra@traycorp.com.br
país:             BR
criado:           20/02/2013
alterado:         03/11/2020
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)


Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

- Lovers
- Estudantes, novo
- Harmonização Ocular
- Laboratório
- Cadêtras
- Similes Dental
- IDOC
- Blog



Digite o que você procura...



Produto	Indicção	Características
---------	----------	-----------------

lônimo de Vidro Restaurador Resiglass - Biodinâmica

Cod. de Referência: 546507

Via opções de quem já comprou

Embalagem com 10g do pó + 8ml de líquido. (R)

Frete Grátis! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00*
*exceto para pedidos de torne bucalina

R\$171,99

Condições de Pagamento [+]

QUANTIDADE: 1

Calcular frete e prazo

O prazo de entrega inicia-se após a confirmação de pagamento.

Indicção

É o material de escolha para tratamento de pacientes com alto risco de cárie. Proporciona a remineralização dos tecidos adjacentes e recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina.

Características

Baseado em 1 avaliação

[Ver todas as avaliações](#)

ESCREVER AVALIAÇÃO...

PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?

[Faça sua sugestão](#)

Visite nosso Blog

Institucional



Acompanhe seu Pedido

Atualizar Pedido

Catálogos de Marcas

IDOC

Nosso Anjo

Sobre a Dental Cremer

Atendimento

0800 727 7565

Seg, a Sex, das 8h às 20h
Sab, das 9h às 13h

Baixe nosso App



Cartão de Crédito
Parcela em até 12x sem juros

Boleto a prazo
Parcela em até 6x sem juros

Boleto à vista
Ganho 3% de desconto



Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Misões, 674 - 2º andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correios): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domiciliares: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Coronado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapava - Minas Gerais - CEP 37555-000 - Farmacêutica responsável: Paola de Souza Foltan - CRF/MG nº 38.001 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Coronado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapava - Minas Gerais - CEP 37555-000

Limpador de Autoclave Clean-Clave - Tecpon

SALVAR

Sobre esta página



Opções de compra

R\$ 122,60

A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra
Dental Web

[Acessar o site](#)

Clean Clave - Limpador de Autoclave Indicação: É um limpador exclusivamente desenvolvido para limpeza e conservação de autoclaves e esterilizantes em geral. Remove com alta eficiência gorduras, muco, restos de leucidos, sangue, sujeiras e resíduos orgânicos em geral, retardando ... [Mais](#)
[Veja mais detalhes em Dental Web »](#)

Comparar opções de compra

Vendido por	Detalhes e ofertas especiais	Preço do item	Preço total	
Dental Web	A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra	R\$ 122,60	R\$ 122,60 Frete não incluído	Acessar o site

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.

Nova Santa Bárbara - PR - Saiba mais

Whois

www.dentalweb.com.br

q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-19 11:33:25 -03:00 - IP: 177.92.7.158

dominio: dentalweb.com.br
 titular: J. P. GOLEM IND. E COM. LTDA
 documento: 01.634.429/0001-01
 responsável: GIOVANI DE MELLO
 país: BR
 c-titular: GIAME
 c-técnico: GIAME
 servidor DNS: ns1.dominios.uol.com.br
 status DNS: 16/08/2021 AA
 último AA: 16/08/2021
 servidor DNS: ns2.dominios.uol.com.br
 status DNS: 16/08/2021 AA
 último AA: 16/08/2021
 servidor DNS: ns3.dominios.uol.com.br
 status DNS: 16/08/2021 AA
 último AA: 16/08/2021
 criado: 12/10/2007 #3960125
 último AA: 16/08/2021
 alterado: 14/10/2020
 expiração: 12/10/2030
 status: Publicado
 contato (ID): GIAME
 nome: GIOVANI ARNALDO DE MELLO
 e-mail: giovani@dentalguiba.com.br
 país: BR
 criado: 11/10/2006
 alterado: 14/10/2009

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
 whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

q PESQUISAR NOVAMENTE

NIC BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
 CNPJ 05.506.560/0001-96



▶ Produtos de consumo (http://equiponorte.com.br/site/produ.../produtos-de-consumo/) Limp Clave (http://equiponorte.com.br/site/produ.../produtos-de-consumo/limp-clave)

▶ Produtos de consumo	Limp Clave	1	(http://equiponorte.com.br/s.../de-consumo/limp-clave?preco=100-250)
▶ Marcas	Dabir Atlante	1	(http://equiponorte.com.br/s.../de-consumo/limp-clave?preco=100-250&marca=5)
▼ Faixa de Preço	R\$100,00 a R\$250,00	1	(http://equiponorte.com.br/s.../de-consumo/limp-clave?preco=100-250)
« Voltar			(http://equiponorte.com.br/s.../de-consumo/limp-clave)

LIMP CLAVE
(HTTP://EQUIPONORTE.COM.BR/LIMP-CLAVE.HTML)
R\$140,00
ou 12x R\$14,06

Adicionar ao carrinho (http://equiponorte.com.br/site/produ.../produtos/46-limp-clave.html)

CONTATO

Matriz - Londrina - Rua Comercindo Saraiva, 65, 86015-250 - Londrina - PR
 0203
 Filial 1 - Maringá (44) 3028-5080
 Filial 2 - Umuarama (44) 3055-4843
 vendas@equiponorte.com.br (/site/contato)

INSTITUCIONAL

▶ Página Inicial (/site/empresa.html?menu_id=55)
 ▶ Localização (/localizacao)
 ▶ Entre em contato (/site/contato)

LOJA

▶ Produtos (/site/produ.../produtos)
 ▶ Carrinho (/site/carrinho)
 ▶ Minha Conta (/site/contato/login)

REDES SOCIAIS

Facebook (https://www.facebook.com/...)

Equiponorte © 2021 - Todos os direitos reservados
 Desenvolvimento e Hospedagem (http://www.zrs.com.br)

Whois

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-19 11:37:50 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:	equiponorte.com.br
titular:	Equiponorte Comércio de Equipamentos Odontológicos
documento:	04.718.950/0001-07
responsável:	Mathheus Negreiros de Souza
país:	BR
c-título:	EQUID6
c-técnico:	RSETI2
servidor DNS:	ns1.zrs.com.br
status DNS:	17/08/2021 AA
último AA:	17/08/2021
servidor DNS:	ns2.zrs.com.br
status DNS:	17/08/2021 AA
último AA:	17/08/2021
sact:	yes
criado:	18/10/2014 #13462409
alterado:	29/10/2018
expiração:	18/10/2021
status:	Publicado
Contato (ID):	EQUID6
nome:	Equiponorte LTDA
e-mail:	matheus@equipomaster.odo.br
país:	BR
criado:	18/10/2014
alterado:	18/10/2014
Contato (ID):	RSETI2
nome:	RMS - Soluções em TI
e-mail:	rcharn@rms.com.br
país:	BR
criado:	13/04/2010
alterado:	29/06/2021

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mailabuse@cert.br. whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

q PESQUISAR NOVAMENTE

dental

Digite o que você procura...



Entrar

Lovers



Meu Carrinho

[Home](#) | [Endodontia](#) | [Limosa De Canal](#) | [Água Oxigenada 10 Volumes - Rioquímica](#)**Produto** | **Indicação** | **Características**

Água Oxigenada 10 Volumes - Rioquímica

Cod. de Referência: 295603

★★★★★ (15)

[Veja opiniões de quem já comprou](#)

Embalagem com 1 litro. Solução de peróxido de hidrogênio 3%

É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA**MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Anvisa Nº 107/2016. AFE Nº 1.01.520-1.****SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO** **Frete Grátis!****NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00***
*Exceto para pedidos de toxina botulínica.**R\$8,50**[Condições de Pagamento \[+\]](#)

QUANTIDADE:

1

[Comprar](#) **Calcular frete e prazo**

O prazo de entrega inicia-se após a confirmação de pagamento.

[Calcular Frete](#)**Indicação****Características**

- * Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%.
- * 36 meses de validade.
- * Aplicar diretamente na lesão, 2 vezes ao dia, ou a critério médico.
- * Sem conservantes.



Baseado em 15 avaliações

[Ver todas as avaliações](#)


ESCREVER AVALIAÇÃO...

Este site utiliza cookies. Para saber mais [clique aqui](#).**PROCUROU E NÃO ACHOU? QUAL PRODUTO VOCÊ GOSTARIA DE VER NA DENTAL CREMER?**[Faça sua sugestão](#)Visite nosso **Blog****Institucional**

[Assistente Virtual](#)
[Dental Cremer Lovers](#)
[Catálogos de Marcas](#)
[iDoc](#)
[Nosso App](#)
[Sobre a Dental Cremer](#)

Ajuda

[Acompanhe seu Pedido](#)
[Atualizar Boleto](#)
[Política Comercial](#)
[Política de Privacidade](#)

**Atendimento****0800 727 7565**Seg. a Sex. das 8h às 20h
Sáb. das 9h às 13h**Baixe nosso App****Cartão de Crédito**
Parcela em até 12x sem juros**Boleto a prazo**
Parcela em até 6x sem juros**Boleto à vista**
Ganhe 3% de desconto

Whois

www.dentalcremer.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2021-08-19 11:47:10 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          dentalcremer.com.br
titular:         DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
documento:       14.190.675/0001-55
responsável:    Paulo Batista
país:            BR
c-titular:       DECRE13
c-técnico:       DECRE13
servidor DNS:    ns-1643.awsdns-13.co.uk
status DNS:     18/08/2021 AA
último AA:      18/08/2021
servidor DNS:    ns-369.awsdns-46.com
status DNS:     18/08/2021 AA
último AA:      18/08/2021
servidor DNS:    ns-1015.awsdns-62.net
status DNS:     18/08/2021 AA
último AA:      18/08/2021
servidor DNS:    ns-1354.awsdns-41.org
status DNS:     18/08/2021 AA
último AA:      18/08/2021
criado:          28/03/2003 #1158372
alterado:        09/08/2016
expiração:       28/03/2025
status:          Publicado

Contato (ID):    DECRE13
nome:            Dental Cremer
e-mail:          dominios@dentalcremer.com.br
país:            BR
criado:          22/11/2013
alterado:        07/01/2016

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Beleza e Perfumaria > Água Oxigenada

AGUA OXIGENADA 10 Volumes 1000 ML - FARMAX

Código gje2kb7hhe | [Ver descrição completa](#) | [Farmax](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Shopping Pro Saude Loja](#)
Entregue por

por R\$ **14,70**

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000 [Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados



Carga Gillette Mach3 Sensitive - 8 Unidades

de R\$62,90 por
R\$62,90 à vista
ou R\$ 62,92
4x de R\$ 15,73 sem juros



Kit com Aparelho de Depilação Feminino -

de R\$65,00 por
R\$74,70 à vista
ou R\$ 74,70
2x de R\$ 37,35 sem juros



Lâmina de Barbear Gillette Fusion - Proshield 2 Peças

de R\$30,90 por
R\$36,90 à vista
ou R\$ 36,90
1x de R\$ 36,90 sem juros



Refil para Escova Elétrica Oral-B Cross Action - 2

de R\$41,90 por
R\$41,90 à vista
ou R\$ 41,90
1x de R\$ 41,90 sem juros



Carga para Aparelho de Barbear Gillette - Mach3

de R\$109,90 por
R\$109,90 à vista
ou R\$ 109,90
7x de R\$ 15,70 sem juros



Creme Facial Antidade L'Oréal Paris Revitalift

de R\$66,90 por
R\$43,49 à vista
ou R\$ 43,49
1x de R\$ 43,49 sem juros



Kit 2 Escovas Raquete e Desembaraça Tangle

de R\$29,14 por
R\$26,23 à vista
ou R\$ 26,23
1x de R\$ 26,23 sem juros



Cortador de Cabelo sem Fio Flex Clipper Cr04-

de R\$105,97 por
R\$100,67 à vista
ou R\$ 105,96
3x de R\$ 35,32 sem juros



6 Ampolas Chantilly C/ Dpantenol, Manteiga

de R\$120,90 por
R\$59,99 à vista
ou R\$ 59,99
1x de R\$ 59,99 sem juros



Mascara De Nutricao Cabelos Danificados

de R\$129,99 por
R\$93,49 à vista
ou R\$ 109,98
3x de R\$ 36,66 sem juros

Quem viu este produto, viu estes também

Whois

www.magazineluiza.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2021-08-19 11:49:47 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: magazineluiza.com.br
titular: MAGAZINE LUIZA S/A
documento: 47.960.950/0001-21
responsável: Andre Fatala
país: BR
c-titular: ANFAT16
c-técnico: REMAG87
servidor DNS: ns-303.awsdns-37.com
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
servidor DNS: ns-1042.awsdns-02.org
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
servidor DNS: ns-1950.awsdns-51.co.uk
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
servidor DNS: ns-687.awsdns-21.net
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
criado: 06/10/1997 #61772
alterado: 29/09/2020
expiração: 06/10/2030
status: Publicado

Contato (ID): ANFAT16
nome: Andre Fatala
e-mail: fatala@luizalabs.com
país: BR
criado: 17/02/2021
alterado: 19/05/2021

Contato (ID): REMAG87
nome: Registro Magazine
e-mail: webmaster@luizalabs.com
país: BR
criado: 22/10/2013
alterado: 04/08/2021

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.


[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Indicador Quimico - Classe 5

Embalagem com 250 unidades.

A partir de R\$ 117,39

Em até 1x R\$ 117,39 sem juros

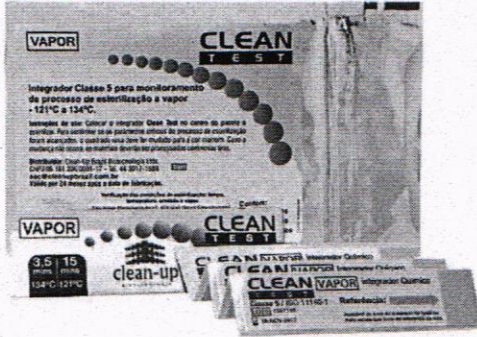

26.9088	R\$ 117,39	ADICIONAR AO CARRINHO
---------	-------------------	-----------------------

Descrição do Produto

Características

- Indicador Classe 5; - Indicador químico por mudança de cor em tira autoadesiva;

Aplicação

Indicado para esterilização a vapor autoclave;

Avaliações

Para ler as avaliações, faça login para escrever suas avaliações.

Cadastre-se para receber nossas ofertas!

Nome

Endereço de email

CADASTRE-SE

SOBRE NÓS

Compra Segura

Como Comprar

Política de Privacidade

Documentos Obrigatórios

Trabalhe Conosco

AJUDA E SUPORTE

Trocas e Devoluções

Formas de Pagamento

Frete e Entrega

Central de Atendimento

Código de Defesa do Consumidor

ATENDIMENTO

0800 941 2490

Seg. a Sex das 8h às 18h

VISITE NOSSAS REDES



MÉTODOS DE PAGAMENTO



© Eventuais promoções, descontos e prazos de pagamento expostos aqui são válidos apenas para compras via site. Em caso de divergência de preço no site, o valor válido é o do carrinho da compra. As fotos são meramente ilustrativas e de propriedade da loja, bem como textos e layouts aqui veiculados. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização. Promoções válidas enquanto durarem os estoques. Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Whois

www.dentalmedsul.com.br

q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-19 12:02:18 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: dentalmedsul.com.br
 título: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA
 documento: 02.477.571/0001-47
 responsável: HUMBERTO DONINI

país: BR
 c-título: TMSU
 c-título: DACS1503

servidor DNS: lvan.ns.cloudflare.com
 status DNS: 18/08/2021 AA
 último AA: 18/08/2021

servidor DNS: kenta.ns.cloudflare.com
 status DNS: 18/08/2021 AA
 último AA: 18/08/2021

alterado: 11/01/2006 #2559109
 criado: 05/08/2021
 expiração: 11/01/2029

status: Publicado
 contato (ID): TMSU

nome: TI DENTAL MED SUL
 e-mail: TI@dentalmedsul.com.br
 país: BR
 criado: 02/08/2012
 alterado: 19/07/2016

contato (ID): DACS1503
 nome: Daniel Carlos da Silva
 e-mail: foxstr1f@gmail.com
 país: BR
 criado: 03/10/2016
 alterado: 03/10/2016

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
 whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

q PESQUISAR NOVAMENTE




(/)

Buscar

INICIAL (/) / ESTERILIZAÇÃO & LIMPEZA (CATEGORIAS/ESTERILIZACAO-LIMPEZA) / INCUBADORAS E INDICADORES (CATEGORIAS/ESTERILIZACAO-LIMPEZA/INCUBADORAS-E-INDICADORES) / INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 ESTERILIZAÇÃO VAPOR 250 UN

INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 ESTERILIZAÇÃO VAPOR 250 UN

Cód.: 17383

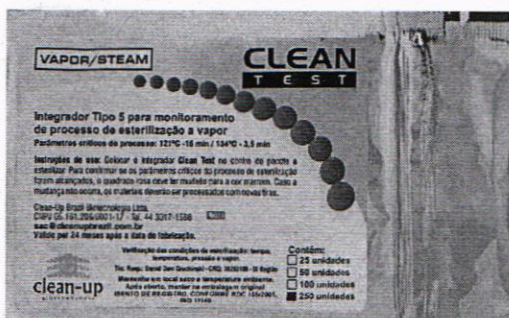

CLEAN UP

lean-up/)

R\$ 92,31 à vista

antecipado (5% desc. já calculado)

em 1x de R\$ 92,31 sem juros (5% de desc. já calculado) as de pagamento ()

enas 90 pt em estoque!
uma quantidade maior? Clique aqui! ()

ui para adicionar a Clinicompras a sua área de trabalho

Informe seu CEP

Não sabe seu CEP? Clique aqui.
(https://buscapeinter.correios.com.br/app/focalidade_logradouro/index.php)

Quem comprou, comprou também...

<p>INDICADOR BIOLÓGICO C LECTURA FINAL NEGAT 48H VAPOR 10UN 3M</p> <p>☆☆☆☆</p>	<p>INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 ESTERILIZAÇÃO VAPOR 25 UN</p> <p>☆☆☆☆</p>	<p>INDICADOR QUIMICO P/ ESTERILIZAÇÃO VAPOR C/100UN CRISTOFOLI</p> <p>☆☆☆☆</p>	<p>TESTE INDICADOR BIOLÓGICO P/AUTOCLAVE C/10 UN</p> <p>☆☆☆☆</p>
<p>Indisponível</p>	<p>Por R\$ 17,10 à vista no boleto antecipado (5% desc. já calculado)</p> <p>No cartão em 1x de R\$ 17,10 sem juros (5% de desc. já calculado)</p>	<p>Por R\$ 181,26 à vista no boleto antecipado (5% desc. já calculado)</p> <p>No cartão em 1x de R\$ 181,26 sem juros (5% de desc. já calculado)</p> <p>No cartão R\$ 190,79 em 3x de R\$ 63,60 sem juros</p>	<p>Por R\$ 35,08 à vista no boleto antecipado (5% desc. já calculado)</p> <p>No cartão em 1x de R\$ 35,08 sem juros (5% de desc. já calculado)</p>
<p>(/produtos/indicador-biologico-c-leitura-final-negat-48h-vapor-10un-3m/)</p> <p><input type="button" value="1"/> <input type="button" value="Comprar"/></p> <p>Produto indisponível</p>	<p>(/produtos/indicador-quimico-classe-5-esterilizacao-vapor-25-un/)</p> <p><input type="button" value="1"/> <input type="button" value="Comprar"/></p>	<p>(/produtos/indicador-quimico-p-esterilizacao-vapor-c100un-cristofoli/)</p> <p><input type="button" value="1"/> <input type="button" value="Comprar"/></p>	<p>(/produtos/teste-indicador-biologico-pautoclave-c10-un/)</p> <p><input type="button" value="1"/> <input type="button" value="Comprar"/></p>

Descrição do produto

Indicador classe 5 esterilização vapor 250 unidades CLEAN.

Características do produto

Indicações	O Integrador químico CLEAN TEST usa uma tinta indicadora que muda de cor e apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da Esterilização por Vapor. Controle da Esterilização.
Diferenciais e benefícios	Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados.



(<https://wa.me/5511951280389/>)

Whois

clinicompras.com.br

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-19 12:00:48 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          clinicompras.com.br
titular:          BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
documento:        06.103.122/0002-70
responsável:     LUCIANO ANTONIO GRUNITZHY
país:             BR
c-titular:        BPHLT3
c-técnico:        BRRIB47
servidor DNS:     ns1.locaweb.com.br
status DNS:       19/08/2021 AA
último AA:        19/08/2021
servidor DNS:     ns2.locaweb.com.br
status DNS:       19/08/2021 AA
último AA:        19/08/2021
servidor DNS:     ns3.locaweb.com.br
status DNS:       19/08/2021 AA
último AA:        19/08/2021
saci:             yes
criado:           31/01/2020 #20613870
alterado:         20/08/2020
expiração:        31/01/2023
status:           Publicado
```

```
Contato (ID):    BPHLT3
nome:            BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e-mail:          marketing@ballke.com.br
país:            BR
criado:          31/01/2020
alterado:        31/01/2020
```

```
Contato (ID):    BRRIB47
nome:            Bruno Ribeiro
e-mail:          bruno.ribeiro@msn.com
país:            BR
criado:          23/05/2013
alterado:        23/05/2013
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Item	Nome do produto/serviço	CATMAT	Preço I - Banco de Preço	Preço II - Banco de preço saúde	Preço III - internet	Preço IV - internet	Média de Preços
1.	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR CX C/ 50. Tubete de 01,80 ml	BR0269843	R\$ 139,30		R\$ 195,30		R\$ 167,30
2.	ANTI- SÉPTICO BUCAL 1,5 L (SEM ALCOOL) Composição: Thymol, Eucaliphtol, Methyl Salicylate, Menthol, Aqua, Sorbitol, Alcohol, Poloxamer 407, Benzoic Acid Aroma, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Propyl Alcohol, CI 42053.		52,70		R\$ 56,91	R\$ 44,99	R\$ 51,53
3.	CARIOSTÁTICO (ESPONJA DE WALTER) 12%		R\$ 37,60		R\$ 46,28	R\$ 48,59	R\$ 44,16
4.	GORRO DESCARTÁVEL tipo gorro c/ tiras laço de amarrar, produto produzidos em polipropileno (tnt), formato anatômico, cor branca. Pacote com 100 unidades.	BR0428627	R\$ 57,00		R\$ 53,90	R\$ 36,11	R\$ 49,00
5.	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL (LIQUIDO+ PO).	BR0404570	R\$ 184,98		R\$ 189,90	R\$ 171,99	R\$ 182,29
6.	LIMPADOR PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AUTOCLAVES E ESTERILIZADORES Frasco com 1 litro. Marca Dabi ou similar		R\$ 100,00		R\$ 122,60	R\$ 140,00	R\$ 120,87

7.	SOLUÇÃO LÍQUIDA DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO sob a fórmula química H ₂ O ₂ , dissolvida em água 3% de peróxido de hidrogênio 97% de água. Embalagem com 1 litro.	BR0277319	R\$ 9,60	R\$ 4,36	R\$ 8,50	R\$ 14,70	R\$ 9,29
8.	TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA MULTIPARAMÉTRICA PARA CONTROLE DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR. Indicador Químico Interno, do tipo multiparamétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura Necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada Caixa com aproximadamente 240 tiras.	BR0332345	R\$ 100,80	R\$ 89,80	R\$ 117,39	R\$ 92,31	R\$ 100,08

Nova Santa Barbára, 19 de outubro de 2021

Patrícia de S. dos A. Siqueira
 Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira
 Responsavel pela Cotação



Município de Nova Santa Bárbara
Solicitação 158/2021

513

Equipiano

Página 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
158	Aquisição de Material	30/06/2021	8
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
19-1	ROSANA RUY DE SOUZA	01/2021	
Local			
Código	Nome		
7	Secretaria de Saúde		
Órgão		Pagamento	
	Nome	Forma	
08	Secretaria Municipal de Saúde		
Entrega			
Local		Prazo	Dias

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
009025	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRICTOR CX C/ 50. Tubete de 1,80 ml. CATMAT BR0269843	CX	3,00	167,30	501,90
004835	ANTI- SEPTICO BUCAL 1,5 L (SEM ALCOOL) Composição: Thy mol, Eucaliptol, Methyl Salicylate, Menthol, Aqua, Sorbitol, Alcohol, Poloxamer 407, Benzoic Acid Aroma, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Propyl Alcohol, CI 42053.	FR	3,00	51,53	154,59
004810	CARIOSTATICO (ESPONJA DE WALTER) 12% CATMAT BR0425821	UN	2,00	44,16	88,32
008058	GORRO DESCARTAVEL tipo gorro c/ tiras laço de amarrar, produto produzidos em polipropileno (tnt), formato anatômico, cor branca. Pacote com 100 unidades. CATMAT BR0428627	PCTE	10,00	49,00	490,00
003451	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVEL (LIQUIDO+ PO). CATMAT BR0404570	CX	10,00	182,29	1.822,90
004856	LIMPADOR PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AUTOCLAVES E ESTERILIZADORES Frasco com 1 litro. Marca Dabi ou similar	FR	2,00	120,87	241,74
008703	SOLUÇÃO LÍQUIDA DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO sob a fórmula química H2O2, dissolvida em água 3% de peróxido de hidrogênio 97% de água. Embalagem com 1 litro. CATMAT BR0277319	UN	5,00	9,29	46,45
007217	TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA MULTIPARAMÉTRICA PARA CONTROLE DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR. Indicador Químico Interno, do tipo multiparamétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura Necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada Caixa com 240 tiras. CATMAT BR0332345	CX	5,00	100,08	500,40
				TOTAL	3.846,30
				TOTAL GERAL	3.846,30



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Sol. 145

514

CORRESPONDÊNCIA INTERNA**DE:** Secretaria Municipal de Saúde**Nº** 234/2021**PARA:** Secretaria de Administração**DATA:** 26/07/21**ASSUNTO:** Solicitação de Inclusão de item na Lista de material de Enfermagem


Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria a inclusão do item relacionado abaixo na lista de material de enfermagem.

Descrição	Qtde
Conjunto de Filtros odontológicos para ar comprimido de ½ polegada. Especificações Técnicas: - Conexão: 1/2Pol. BSP - Vazão a 6 bar: 2138 l/min - Pressão de Trabalho: 0 a 10 bar - Pressão Máxima de Entrada: 12 bar - Fluido: Ar comprimido - Temperatura de Trabalho: -10° C a +60° C - Capacidade do copo: 0,15 l - Conexão dos Manômetros: 1/8Pol. BSP - Escala dos Manômetros: 0 a 160 PSIG e a 11 bar - Elementos Coalescentes: Grau "U" ou Grau "F" - Elemento Adsorvente: Carvão Ativado - Elemento Filtrante: Polietileno - Elementos Coalescentes: Fibra Borosilicato - Manopla: Acetal - Suportes: Alumínio - Tirantes: Aço - Copo: Policarbonato Transparente	01

Atenciosamente,


Rosana Ruy de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por:


Nome


Assinatura

26/07/2021
Data



banQiZ* via do boletoChuva de CupomMe Chama no Zap!Mundo GamerBaixe o APPRetira GrátisVenda seus produtos

Casasbahia.com.br > Ferramentas > Compressores de Ar e Acessórios > Acessórios para Compressores de Ar

thumb of product thumb of product thumb of product thumb of product

★★★★★ (0 avaliações)

Vendido por LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA e entregue por Casas Bahia

Conjunto De Filtros Odontológicos Para Ar Comprimido 1/2 Polegada - Werk Schott

[Cód. Item 1519469962] Outros produtos Não Informada

R\$ 693,00

ou até 10x de R\$69,30 sem juros ver parcelamento

Comprar

R\$ 693,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 10x de R\$ 69,30 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega

86250-000

Nova Santa Bárbara - PR

Normal

9 dias úteis

R\$ 83,75

Ver regras de frete



Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx

Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA USO ODONTOLÓGICO

Os Conjuntos Odontológicos Werk-Schott são elementos indispensáveis em toda instalação pneumática corretamente projetada. São necessários para a purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores

O ar comprimido utilizado nos equipamentos odontológicos deve ser isento de contaminação por partículas sólidas, de aerossóis de água e de óleos contaminantes, que os sistemas de filtragem convencionais não eliminam. Os sistemas de secagem podem remover a água do ar comprimido, mas não removem o óleo contaminante que é introduzido pelos compressores de ar, mesmo utilizando-se de um compressor de funcionamento a seco (sem óleo). A contaminação acontece porque o ar ambiente pode conter de 20 a 30 ppm de hidrocarbonetos em suspensão, originários da queima de combustíveis. Os filtros convencionais de filtragem nominal de 5 micra não removem partículas contaminantes submicrônicas; estes filtros de uso convencional, removem partículas maiores que 2 micra; 80% das partículas sólidas em suspensão são menores que 2 micra e os aerossóis são menores que 0,2 micra. Os filtros coalescentes foram projetados para remover partículas submicrônicas sólidas, de óleo e de água do ar comprimido. A eficiência de remoção de partículas é de 0,3 a 0,6 µm; o que representa de 98,5% a 99,9999%.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade.
- Redução do óleo contido no ar proveniente dos compressores e tubulações de ar, proporcionando melhor eficiência das restaurações adesivas.
- Redução da manutenção dos equipos.
- Redução de impurezas na boca do paciente

FUNÇÕES

- Filtro Regulador: mantém a pressão de operação constante, independente das flutuações da pressão primária e do consumo de ar; pré-filtragem dos filtros coalescentes, retendo as partículas sólidas e gotas de umidade com valor absoluto de 5 µm
- Filtro de Ar Comprimido com Elemento Filtrante Coalescente Grau "F" (cor azul): com eficiência de 98,5% na remoção de partículas de 0,3 a 0,6 µm e com quantidade máxima de óleo de 0,5 mg/m³.
- Filtro de Ar Comprimido com Elemento Filtrante Coalescente Grau "U" (cor verde): com eficiência de 99,9999% na remoção de partículas de 0,3 a 0,6 µm e com quantidade máxima de óleo de 0,1 mg/m³.
- Filtro de Ar Comprimido com Elemento Filtrante Adsorvente de Carvão Ativado (cor cinza): para eliminação final dos últimos traços de hidrocarbonetos da corrente gasosa de até 0,03 mg/m³.

- Especificações Técnicas:

- :: Conexão: 1/2Pol. BSP
- :: Vazão a 6 bar: 2138 l/min
- :: Pressão de Trabalho: 0 a 10 bar
- :: Pressão Máxima de Entrada: 12 bar
- :: Fluido: Ar comprimido
- :: Temperatura de Trabalho: -10° C a +60° C
- :: Capacidade do copo: 0,15 l
- :: Conexão dos Manômetros: 1/8Pol. BSP
- :: Escala dos Manômetros: 0 a 160 PSIG e a 11 bar
- :: Elementos Coalescentes: Grau "U" ou Grau "F"
- :: Elemento Adsorvente: Carvão Ativado
- :: Elemento Filtrante: Polietileno
- :: Elementos Coalescentes: Fibra Borossilicato
- :: Manopla: Acetal

Whois

www.casabahia.com.br

q

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-19 15:37:33 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio:	casabahia.com.br
titular:	VIA VAREJO S/A
documento:	33.841.268/0652-90
responsável:	VIA VAREJO S.A.
país:	BR
c-titular:	APMCAS8
c-técnico:	POCTE
servidor DNS:	ns1-182.akam.net
status DNS:	19/08/2021 AA
último AA:	19/08/2021
servidor DNS:	ns1-240.akam.net
status DNS:	19/08/2021 AA
último AA:	19/08/2021
servidor DNS:	usw2.akam.net
status DNS:	19/08/2021 AA
último AA:	19/08/2021
servidor DNS:	usw2.akam.net
status DNS:	19/08/2021 AA
último AA:	19/08/2021
servidor DNS:	usw2.akam.net
status DNS:	19/08/2021 AA
último AA:	19/08/2021
servidor DNS:	usw3.akam.net
status DNS:	19/08/2021 AA
último AA:	19/08/2021
servidor DNS:	usw5.akam.net
status DNS:	19/08/2021 AA
último AA:	19/08/2021
criado:	21/01/1997 #28393
alterado:	30/06/2021
expirado:	21/01/2031
status:	Publicado
Contato (ID):	APMCAS8
nome:	Adriano Palaoro Mesquita Carneiro
e-mail:	amc@muradpma.com
país:	BR
criado:	16/07/2020
alterado:	16/07/2020
Contato (ID):	POCTE
nome:	Pontofrio.com Contato Técnico
e-mail:	tl.seguranca.informacao@viavarejo.com.br
país:	BR
criado:	25/08/2008
alterado:	06/07/2021

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.

whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

q PESQUISAR NOVAMENTE

Alterar visualização para modo padrão

NIC BR - Modelo de Informação e Coordenação do Ponto BR
 CNPJ: 05.506.560/0001-36

COMPRESSOR DE FILTRO (https://www.meucompressor.com.br/compressor-de-filtro)
Compressor de Filtro (https://www.meucompressor.com.br/compressor-de-filtro)
Compressor de Filtro (https://www.meucompressor.com.br/compressor-de-filtro)

PARCELA 6X Sem juros nos cartões de crédito para todo o Brasil

NOTA FISCAL Para todos os produtos. Disponível para todo o Brasil


ENVIO Rápido Disponível para todo o Brasil

CONJUNTO DE FILTROS ODONTOLÓGICOS PARA AR COMPRIMIDO 1/2 POLGADA - WERK SCHOTT
 Códigos: CO0183C MA64, WERK SCHOTT (https://www.meucompressor.com.br/ma64-werk-schott.html)

R\$ 693,00 6x em R\$ 115,50 sem juros
R\$ 623,70 no boleto 5% de desconto

1 ESTOQUE DISPONÍVEL

COMPRAR (HTTPS://WWW.MEUCOMPRESSOR.COM.BR/CARRINHO/PROD)

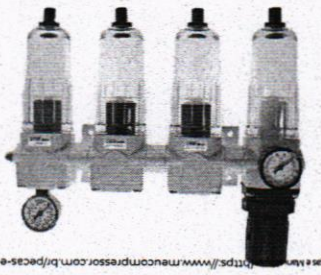

BNDES 48X Pague com o cartão BNDES 48X
 Cmpg ogul

Atenção: Para comprar com o cartão BNDES, você deverá clicar em **Comprar aqui** (página/carrinho-bndes.htm) e **completar as informações solicitadas** para darmos seguimento ao procedimento de redução do pagamento.


Modelo	Preço
1x de R\$ 693,00 sem juros	R\$ 693,00
2x de R\$ 346,50 sem juros	R\$ 346,50
3x de R\$ 231,00 sem juros	R\$ 231,00
4x de R\$ 173,25 sem juros	R\$ 173,25
5x de R\$ 138,60 sem juros	R\$ 138,60
6x de R\$ 115,50 sem juros	R\$ 115,50
7x de R\$ 97,03 sem juros	R\$ 97,03
8x de R\$ 84,86 sem juros	R\$ 84,86
9x de R\$ 77,98 sem juros	R\$ 77,98
10x de R\$ 69,30 sem juros	R\$ 69,30

Calcular frete

CEP:

Compartilhe esse produto

Conheça o Produto

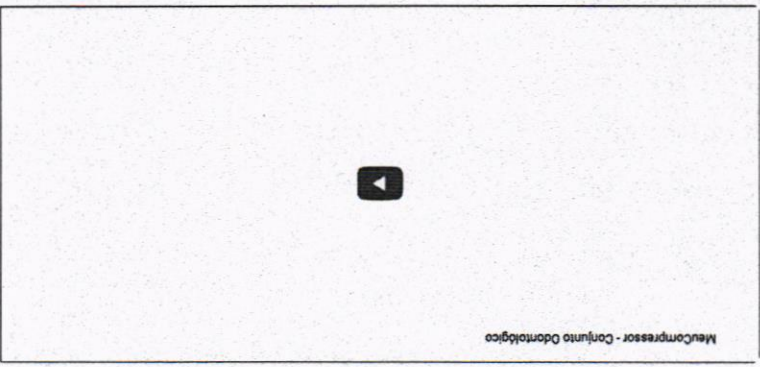

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA USO ODONTOLÓGICO

Os Conjuntos Odontológicos Werk-Schott são elementos indispensáveis em toda instalação pneumática corretamente projetada. São necessários para a purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrômetros e odores.

O ar comprimido utilizado nos equipamentos odontológicos deve ser isento de contaminação por partículas sólidas, de aerossóis e de óleos contaminantes, que os sistemas de filtração convencionais não eliminam. Os sistemas de ecacção podem remover a água do ar comprimido, mas não removem o óleo contaminante que é introduzido pelos compressores de ar, mesmo utilizando-se de um compressor de funcionamento a seco (sem óleo). A contaminação ocorre porque o ar ambiente pode conter de 20 a 30 ppm de hidrocarbonetos em suspensão, originários da queima de combustíveis. Os filtros convencionais de filtração nominal de 5 micras não removem as partículas contaminantes, estes filtros de uso convencional removem as partículas maiores que 2 micras. 80% das partículas sólidas em suspensão são partículas submicroscópicas sólidas, de óleo e de água do ar. Os filtros coalescentes filtram projetados para remover partículas submicroscópicas sólidas, de óleo e de água do ar comprimido. A eficiência de remoção de partículas é de 0,3 a 0,6 µm, o que representa de 98,5% a 99,9999%.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade.
- Redução do óleo contido no ar proveniente dos compressores e tubulações de ar, proporcionando melhor eficiência das restaurações adesivas.
- Redução da manutenção dos equipamentos.
- Redução de impurezas na boca do paciente.

FUNÇÕES

- Filtro regulador: mantém a pressão de operação constante, independente das flutuações da pressão primária e do consumo de ar; pré-filtragem dos filtros coalescentes, retendo as partículas sólidas e gotas de umidade com valor absoluto de 5 µm.
- Filtro de Ar Comprimido com Elemento Filtrante Coalescente Grau "F" (cor azul) com eficiência de 98,5% na remoção de partículas de 0,3 a 0,6 µm e com quantidade máxima de óleo de 0,5 mg/m³.
- Filtro de Ar Comprimido com Elemento Filtrante Coalescente Grau "U" (cor verde) com eficiência de 99,9999% na remoção de partículas de 0,3 a 0,6 µm e com quantidade máxima de óleo de 0,1 mg/m³.
- Filtro de Ar Comprimido com Elemento Filtrante Adsorvente de Carvão Ativo (cor cinza): para eliminação final dos últimos traços de hidrocarbonetos da corrente gasosa de até 0,03 mg/m³.

Especificações Técnicas:

- Condição: 1/2 Pol. BSP
- Vazão a 6 bar: 2138 l/min
- Pressão de Trabalho: 0 a 10 bar
- Pressão Máxima de Entrada: 12 bar

Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2021-08-19 15:32:44 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: meucompressor.com.br
titular: Luat Comércio de Compressores e Peças Ltda
documento: 05.689.439/0001-97
responsável: Luciano Albertin
país: BR
c-titular: LUA268
c-técnico: LUA268
servidor DNS: ns604.hostgator.com.br
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
servidor DNS: ns605.hostgator.com.br
status DNS: 18/08/2021 AA
último AA: 18/08/2021
saci: yes
criado: 27/08/2018 #18738570
alterado: 07/12/2019
expiração: 27/08/2021
status: Publicado

Contato (ID): LUA268
nome: Luciano Albertin
e-mail: luciano@luat-aircenter.com.br
país: BR
criado: 19/09/2004
alterado: 29/04/2020
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

**NOVA SANTA BÁRBARA**

Eu Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, responsável pela cotação de preços deste departamento de licitação, Declaro que em data do dia 19 de outubro de 2021 realizei pesquisa de preços no EngeMed Hospitalar Ltda, CNPJ 37.309.633/0001-96, do item abaixo relacionado:

Item	Produto	Valor Unitário
1.	Conjunto de filtros odontológicos para ar comprimido de ½ polegadas Especificações técnicas: - conexão: ½ pol. BSP - vazão a 6 bar: 2138 l/min - Pressão de trabalho: 0 a 10 bar - Pressão máxima de entrada: 12 bar - Fluido: Ar comprimido - Temperatura de trabalho: -10° C a + 60° C - Capacidade do copo: 0,15 l - conexão dos manômetros: 1/8 pol. BSP - Escala dos Manômetros: 0 a 160 PSIG e a 11 bar - Elementos coalescentes: grau "U" ou grau "F" - Elemento adsorvente: Carvão ativado - elemento filtrante: polietileno - Elementos coalescentes: fibra borosilicato - manopla: Acetal - suportes: alumínio - Tirantes: aço - Copo: policarbonato transparentes	1.180,00

Patrícia de S. dos A. Siqueira

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Item	Produto	Preço I -Internet	Preço II - Internet	Preço III - Declaração	Média de Preços
1	Conjunto de filtros odontológicos para ar comprimido de ½ polegadas Especificações técnicas: conexão: ½ pol. BSP, vazão a 6 bar: 2138 l/min, Pressão de trabalho: 0 a 10 bar, Pressão máxima de entrada: 12 bar, Fluido: Ar comprimido, Temperatura de trabalho: -10° C a + 60° C, Capacidade do copo: 0,15 l, conexão dos manômetros: 1/8 pol. BSP, Escala dos Manômetros: 0 a 160 PSIG e a 11 bar, Elementos coalescentes: grau "U" ou grau "F", Elemento adsorvente: Carvão ativado, elemento filtrante: polietileno, Elementos coalescentes: fibra borosilicato, manopla: Acetal, suportes: alumínio, Tirantes: aço, Copo: policarbonato transparentes	R\$ 693,00	R\$ 623,70	R\$ 1.180,00	R\$ 832,23

Nova Santa Bárbara, 19 de outubro de 2021

Patricia de S. dos A. Siqueira

Patricia de Souza dos Anjos Siqueira

Responsável pela cotação